

Berührungslose Temperaturmessung

Scanner SC 1012

Mit dem Scannervorsatz SC 1012 wird jedes Infrarothermometer der KTR-Serie zum Linienscanner. Typische Anwendungen: schwingende Drähte, verzünderte Schmiedeteile, Kettenvergütungen, Kabel, Gummiprofile, Papierwalzen, Kantenerkennung, schlechtgeführte Teile usw..

Die herausragenden Leistungsmerkmale dieses Scanners sind – variable Scangeschwindigkeit sowie diverse anwendungsbezogene optionelle Ausbaustufen.



Technische Daten:

Scannwinkel	: 6°
Scangeschwindigkeit	: 2 - 12 Messungen/sek.
Versorgungsspannung	: 24 V DC/AC
Stromaufnahme	: 200 mA
Maße: H / B / T	: 54 x 54 x 173mm
Gewicht	: 0.6 kg
Betriebstemperatur	: 0 - 60°C
Schutzart	: IP 65 (mit Schutzfenster)

Infrarot – Strahlungsthermometer helfen auch Ihnen, Ihre Erwärmungsprozesse zu überwachen. Sie sichern Ihnen die gleichmäßige Qualität Ihrer Erzeugnisse.

Prospekt Scanner SC1012

Dr. Georg Maurer GmbH
-Optoelektronik-

GRUBATEC



MESS- UND REGELTECHNIK

Grubatec AG
Wölferstrasse 5
4414 Füllinsdorf
Telefon: +41 (0)55 617 00 80
Telefax: +41 (0)55 617 00 81
www.grubatec.ch
sales@grubatec.ch

Scanner SC 1012 -Standardausführung-

Funktionen:

Einstellbare Scangeschwindigkeit durch Potentiometer.

Betriebswahl:

Dauermessung : Scanner läuft kontinuierlich.

Manuelle Messung : Start durch externes Signal

Ausgänge: Impulsausgang der Wendepunkte für externe Signalverarbeitung

Optionen:

Maximalwertspeicher 0(4)-20 mA: Art.-Nr. 117-2002

Für Überwachungsaufgaben wo der Temperatur-Spitzenwert erfasst werden muß, ist diese Option eine sinnvolle Erweiterung. Der gemessene Temperaturwert wird als Analogsignal 0 (4)-20 mA = dem Temperaturbereich des verwendeten Infrarot-Strahlungsthermometers ausgegeben.

Es stehen 2 "Reset"-Funktionen zur Verfügung:

1) extern : Reset über Fremdkontakt

2) automatisch : Die Meßwertaktualisierung erfolgt an jedem Wendepunkt.

Schutzfenster:


Zur Abdichtung des Scanners gegen Staub und Spritzwasser stehen verschiedene auswechselbare Schutzfenster zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt durch den jeweils verwendeten Spektralbereich des Infrarot-Strahlungsthermometers.

Art.-Nr.:	Material:	Spektralbereich:
117-2011	Quarzglas	0,4 - 3 µm
117-2012	CaF2	0,4 - 11 µm
117-2013	ZnSe	8 - 14 µm AR

Zubehör:

117-2003 Verbindungskabel Scanner zu KTR 0,5 m lang
117-2005 Anschlußkabel Scanner mit freien Enden 2 m lang
117-2004 Verbindungskabel Scanner zu AE10XX 2 m lang
116-1136 Montagehalterung für KTR

- weiteres Zubehör sowie Anzeigegeräte auf Anfrage -

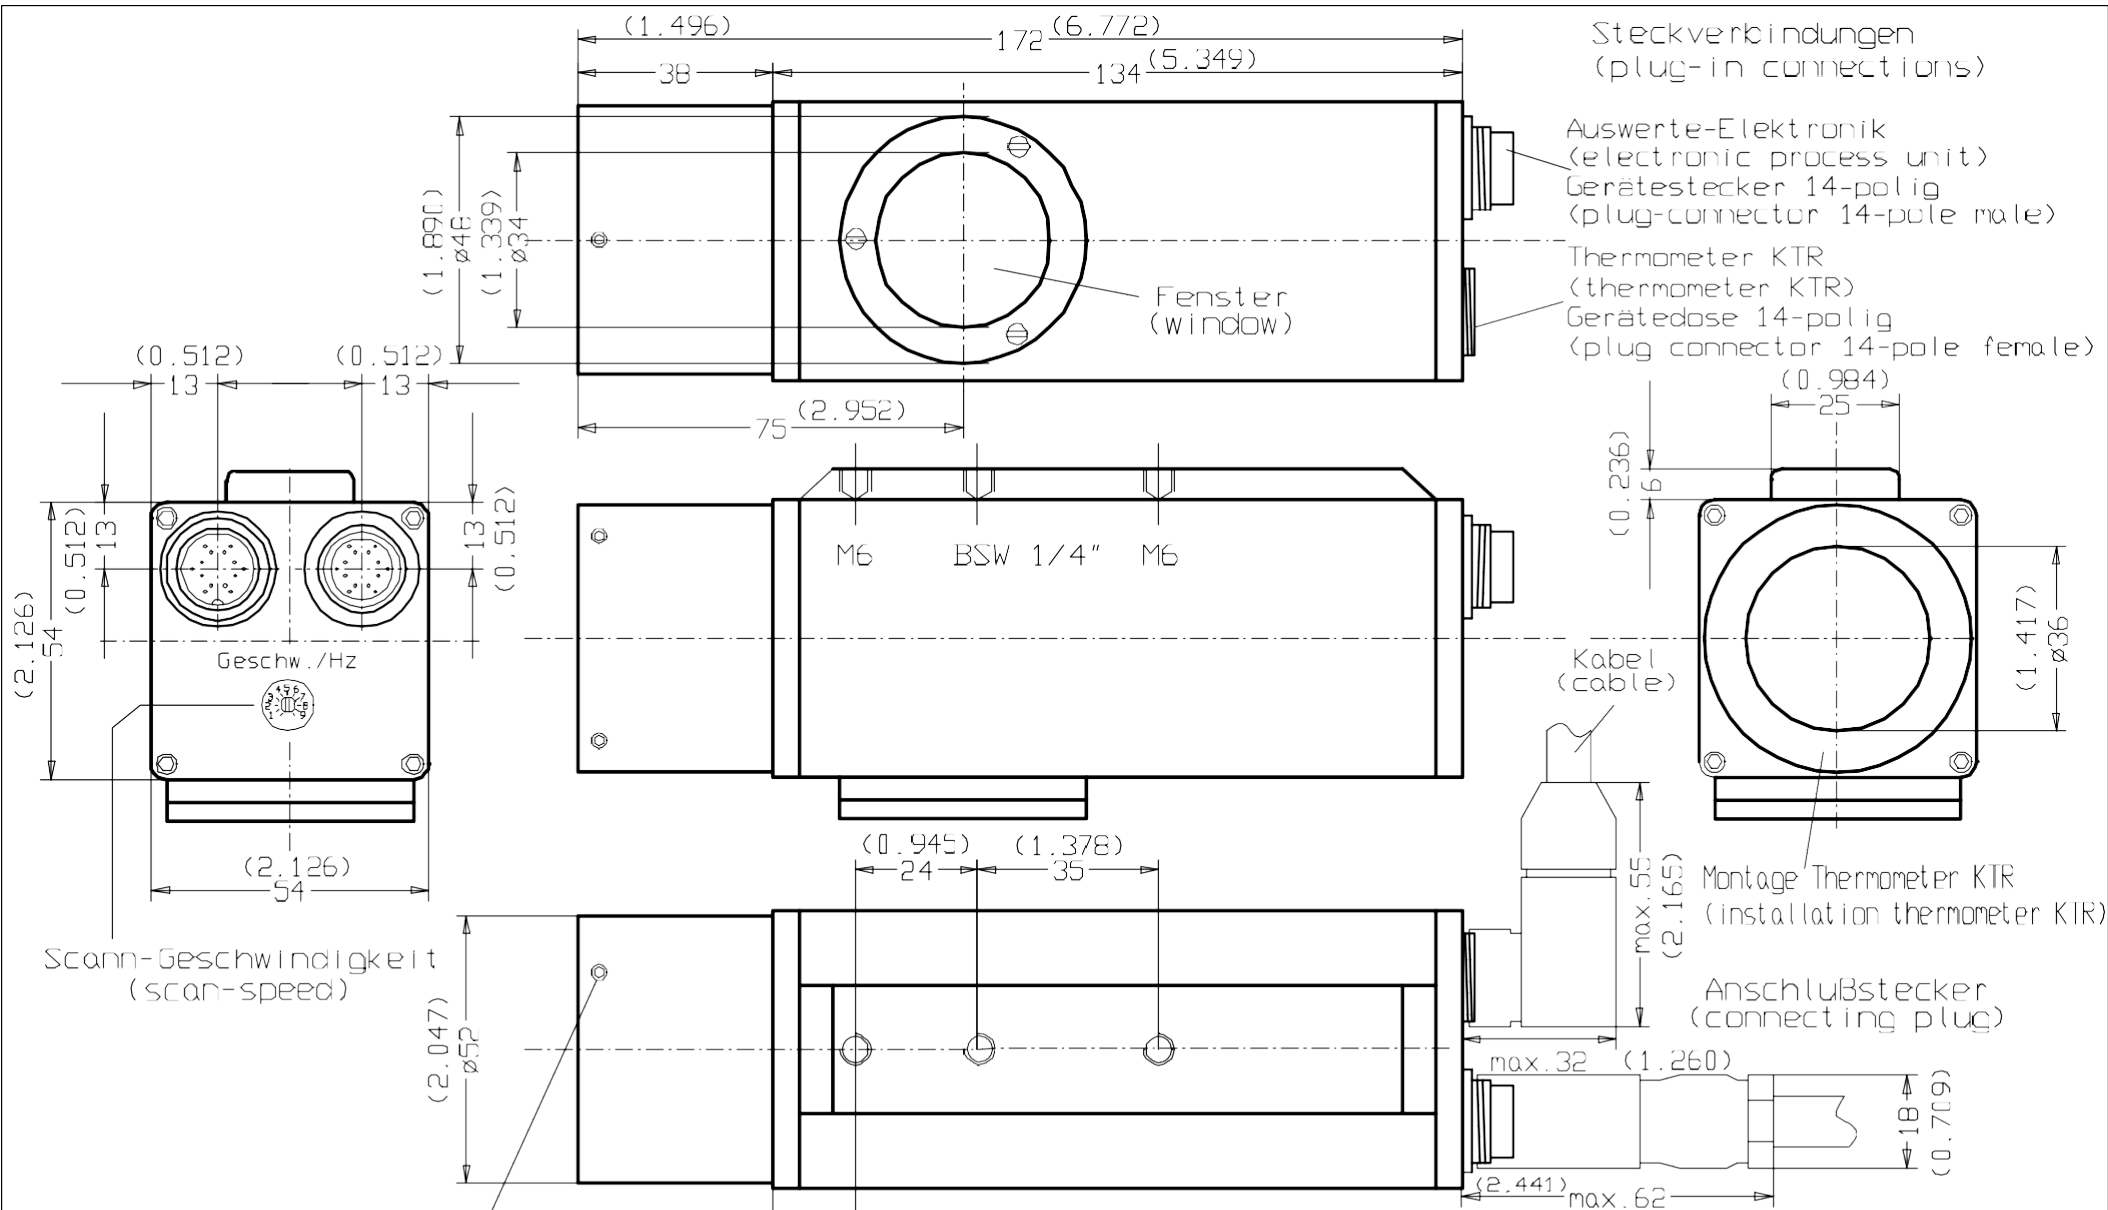

Scann-Geschwindigkeit
(scan-speed)

Feststellschrauben
(locking screws)
Thermometer KTR
(thermometer KTR)

(xxx) - Maße in Zoll
(dimensions inch)

				Maßstab 1:1	
				STANDARDGEHÄUSE (standard case)	
				SCANNER SC1012	
				Blatt	
				Bl.	
		Datum		Name	
		Bearb 02.11.99		Schlotterb.	
		Gepr			
		Norm			
		11.06.03		99 11 01	
Zust	Änderung	Datum	Name		