

Digitales MAURER Pyrometer

KTRD 2300

Messbereiche 50 bis 1200 °C

UNIVERSALGERÄT



Leistungsstärke, Präzision und Zuverlässigkeit – darauf können Sie bei MAURER-Pyrometer zählen. Profitieren Sie von einer maximalen Anpassbarkeit durch Auswahl der richtigen Optik, Zubehöerteilen und der passenden Schnittstelle. So fügt sich unser Pyrometer perfekt in bestehende Systeme ein.

Die wichtigsten Funktionen und Eigenschaften auf einen Blick:

- Spektralbereich: 2,3 µm
- Kurze Ansprechzeit von unter 0,5 ms bis 5 ms
- Emissionsfaktor von 100 – 10 %, direkt am Gerät oder über Schnittstelle einstellbar
- Lichtstrahlzieleinrichtung (LED / Laser), mit einem Ziellicht, das mit dem tatsächlichen Messpunkt in Größe und Position exakt übereinstimmt
- Mit Vario-Optik zur exakten Fokussierung auf die Messstelle
- Mit digitalem und analogem Ausgang nutzbar
- 1 Schaltausgang (open collector)
- Betriebsspannung 24 V DC
- Freie Software (IR-LOG) zur Parametrierung, sowie Messwertaufzeichnung und Archivierung

Messbereiche

1. 50 – 400 °C
 2. 70 – 550 °C
 3. 100 – 700 °C
 4. 150 – 1200 °C
- Sondermessbereiche auf Anfrage -

Häufige Anwendungsgebiete

Verarbeitung von Stahl, Eisen, Buntmetallen und Drähten, Keramik, Induktionserwärmung, Walzen, Löten, Schweißen, Umformen, Vakuum-Ofen usw.



Technische Daten

Gerätetypen	KTRD 2300-1	KTRD 2300-2
Messfleckmarkierung	Lichtstrahlzieleinrichtung mit LED (grün) oder Laser	Visiereinrichtung
Ansprechzeit	Messbereich 1+2: 5 ms Messbereich 3+4: < 0,5 ms	
Spektralbereich	2,3 µm	
Messunsicherheit	0,5 % ± 1 °C (ε = 1, Tu = 23°C, T 95 = 1s)	
Temperaturabhängigkeit	0,05 % / °C	
Reproduzierbarkeit	0,1 % ± 1 °C (ε = 1, Tu = 23°C, T 95 = 1s)	
Emissionsfaktor	100 – 10 %, am Gerät oder über Schnittstelle einstellbar	
Auflösung	< 0,1 % am Analogausgang < 0,1 °C an der Schnittstelle	
Betriebs- / Lagertemperatur	0 – 50 °C, Optik 150 °C / -10 °C – 70 °C	
Zulässige Feuchte	35 – 85 % RF (nicht kondensierend)	
Ausgang temperaturlinear	0 – 20 mA bzw. 4 – 20 mA (Bürde max. 500 Ω)	
Teilmessbereich	frei einstellbar innerhalb des Messbereichs	
1 Schaltausgang (open coll.)	24 V 100 mA	
Schnittstelle	RS 232 ± 50 V isoliert <u>oder</u> RS 485 ± 70 V isoliert Optional: PROFIBUS, PROFINET, Ethernet, EtherCAT, USB 2.0	
Maximalwertspeicher	Max. Speicher, Doppelspeicher, einstellbare Zeit und Schwellwert, Löschen nach Zeit, externer Kontakt, per Software, bei neuem Messgut	
Betriebsspannung	24 V DC ± 10 %	
Stromaufnahme	< 100 mA	
Geräteanschluss	12-pol. Steckverbindung	
Maße (BxHxT) / Gewicht	54 x 54 x 147mm / 0,6 kg	
Schutzart	IP65	

Konfigurationsmöglichkeiten:

- Eingebaute Digitalanzeige auf der Rückseite des Pyrometers
- Umfangreiche Auswahl an Objektiven, passend für die jeweilige Messaufgabe


Haupt-Zubehör:

Elektronisches Zubehör		Mechanisches Zubehör	
Div. Anschlusskabel	Netzteil 100-270 VAC – 24 VDC	Optiken	Strahlumlenkung 90°
Auswerteelektroniken	PC-Box (USB-Anschlussset)	Montagehalter	Blasvorsatz
(Linien-) Scanner		Kühlgehäuse	

Optiken für **MAURER** Pyrometer

KTRD 2300

ÜBERSICHT

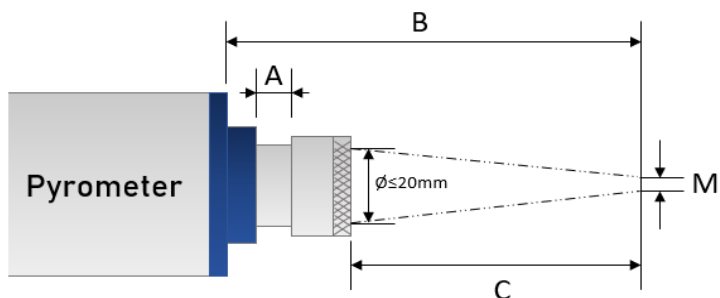

Messbereich

- | | | |
|----|---------------------|---------------------|
| 1. | Messblende = 1,0 mm | Messfleck = M x 1 |
| 2. | Messblende = 0,7 mm | Messfleck = M x 0,7 |
| 3. | Messblende = 0,5 mm | Messfleck = M x 0,5 |
| 4. | Messblende = 0,3 mm | Messfleck = M x 0,3 |

Sonderlösungen auf Anfrage

Legende


- | | |
|---|----------------------------------|
| A | Optik-Auszug |
| B | Messabstand ab Gehäusekante |
| C | Messabstand ab Optik-Vorderkante |
| M | Messfleck-Größe |

Optik	IR 2050 N0D			
Linse	F 50, Ø 25,4 mm			
Messblende	Ø 1,0 mm			
B	C	A	M	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
158,0	102,0	13,0	1,7	
166,7	117,0	6,7	2,0	
180,0	137,0	0,0	2,5	

Optik	IR 2050 N1D			
Linse	F 50, Ø 25,4 mm			
Messblende	Ø 1,0 mm			
B	C	A	M	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
190,0	146,6	13,0	2,7	
200,0	159,2	10,6	2,9	
220,0	182,6	7,2	3,0	
240,0	205,6	4,2	3,5	
260,0	227,1	2,7	4,0	
280,0	247,8	2,0	4,5	
300,0	269,8	0,0	5,0	

Optik	IR 2050 N2D			
Linse	F 50, Ø 25,4 mm			
Messblende	Ø 1,0 mm			
B	C	A	M	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
200	166,0	13,0	3,0	
220	188,5	10,5	3,4	
250	221,3	7,7	4,0	
300	273,6	5,4	5,0	
350	325,5	3,5	6,0	
400	376,4	2,6	7,0	
450	427,6	1,4	8,1	
500	478,1	0,9	9,1	
550	528,5	0,5	10,1	
600	579,0	0,0	11,2	



Optik	IR 2050 TD			
Linse	F 50, Ø 25,4 mm			
Messblende	Ø 1,0 mm			
B	C	A	M	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
220	186,0	13,0	3,7	
300	270,0	9,0	5,2	
400	372,5	6,5	7,3	
500	474,0	5,0	9,7	
800	775,9	3,1	15,5	
1000	977,0	2,0	20,0	
2000	1978,0	1,0	42,0	
3000	2978,4	0,6	63,0	
5000	4978,8	0,2	107,0	

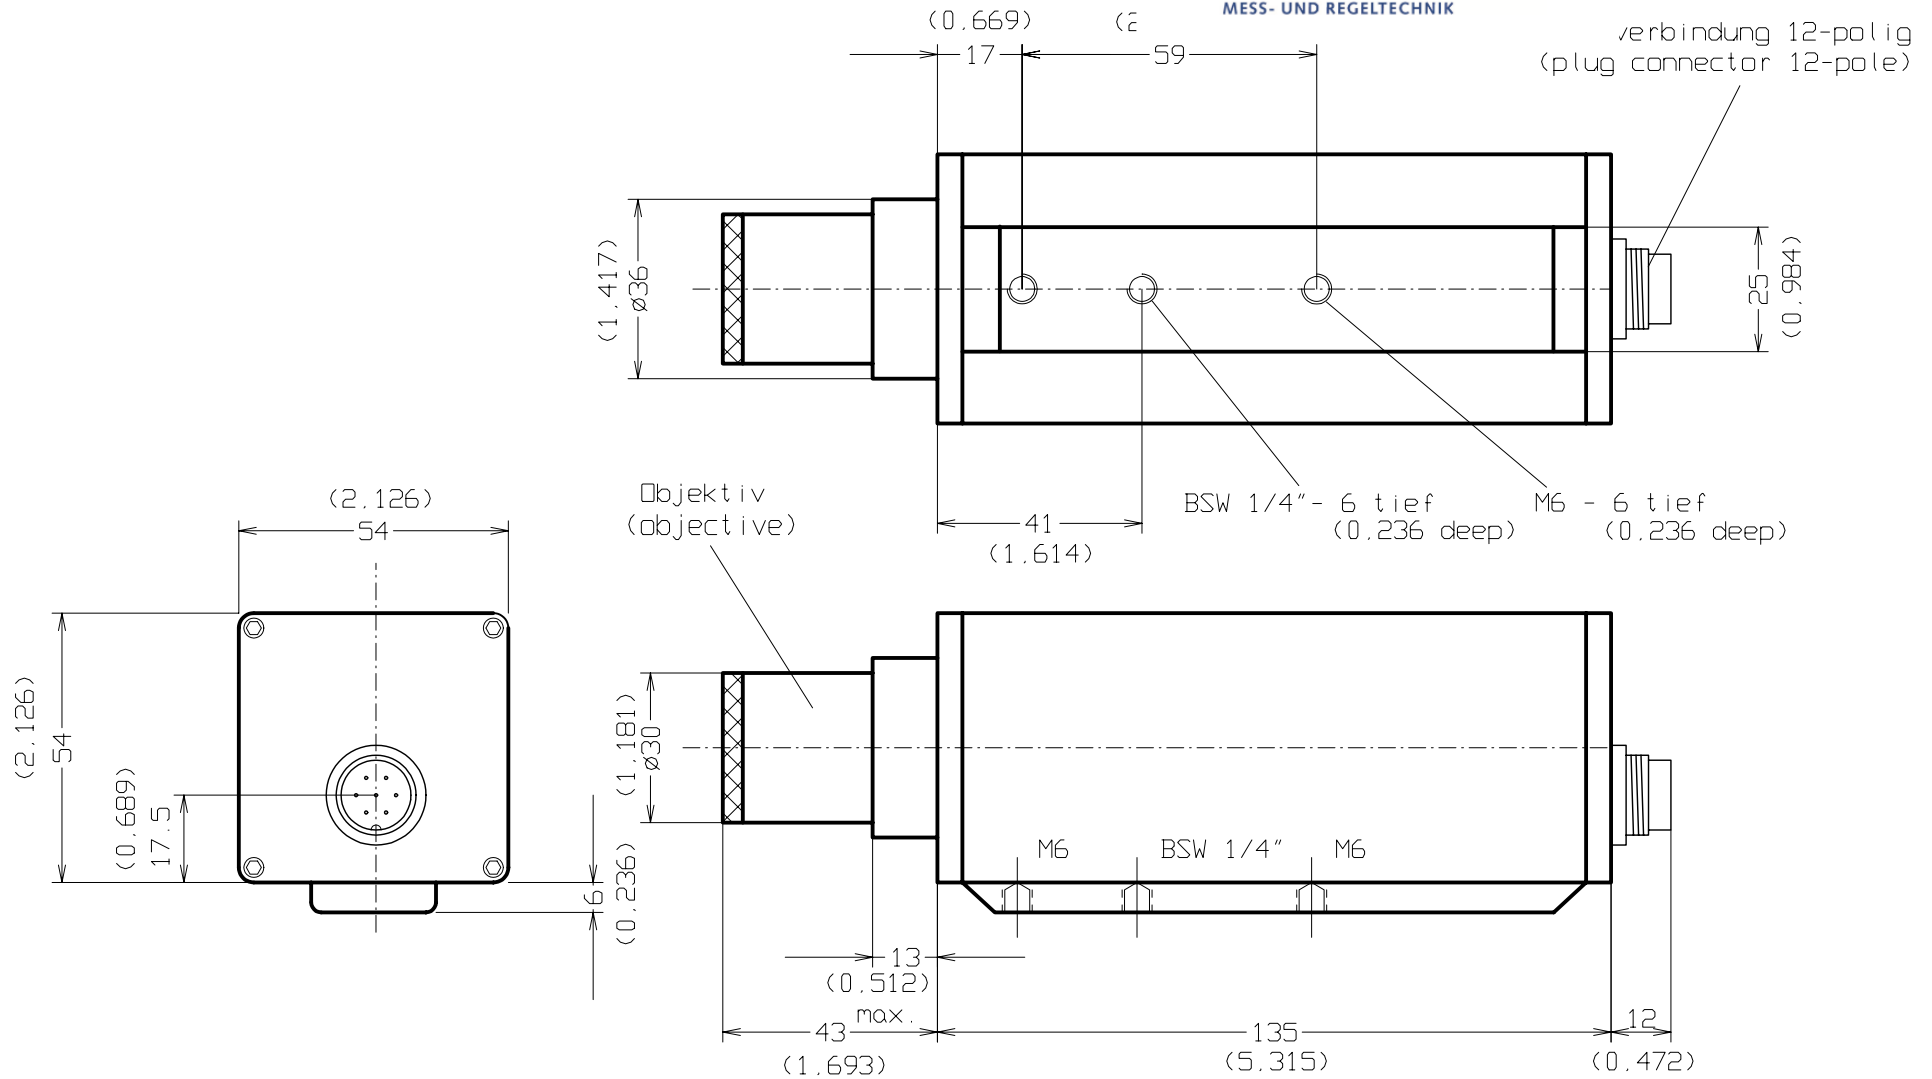

(xxx) - Maße in Zoll
(dimensions inch)

						Maßstab		1:1			
						Fa.Dr. Maurer GmbH					
					Datum	Name		STANDARDGEHÄUSE (standard case) KTRD 1000-1			
				Bearb.	25.02.10	Schlötterb.					
				Gepr.							
				Norm							
						100205					
						Blatt					
						Bl.					
Zust.	Änderung	Datum	Name								

Visiereinrichtung
(viewfinder)

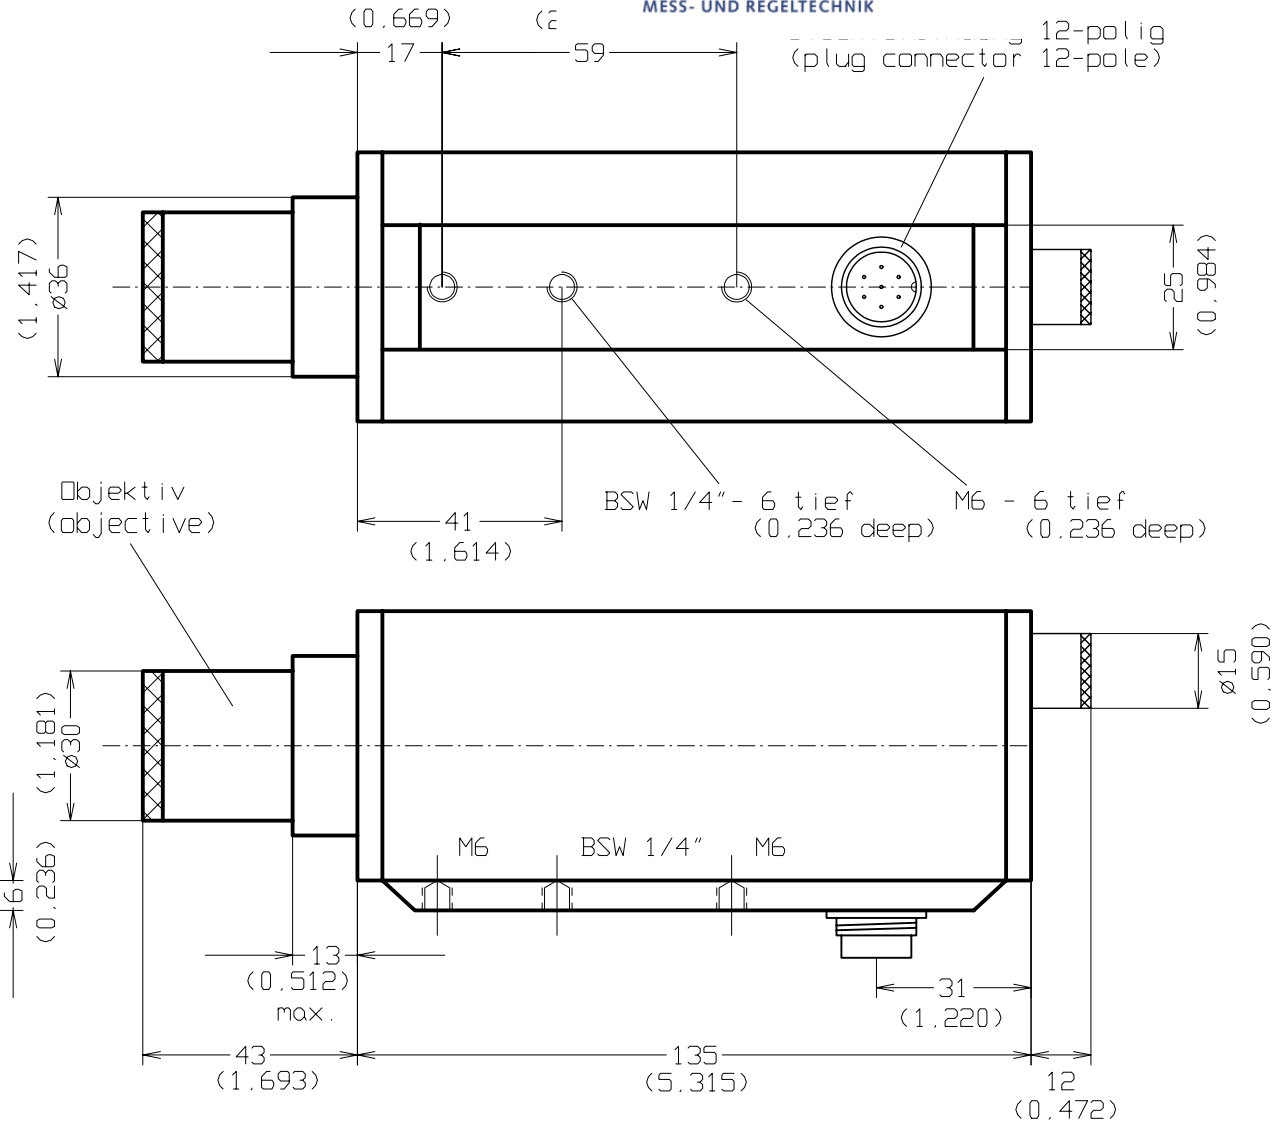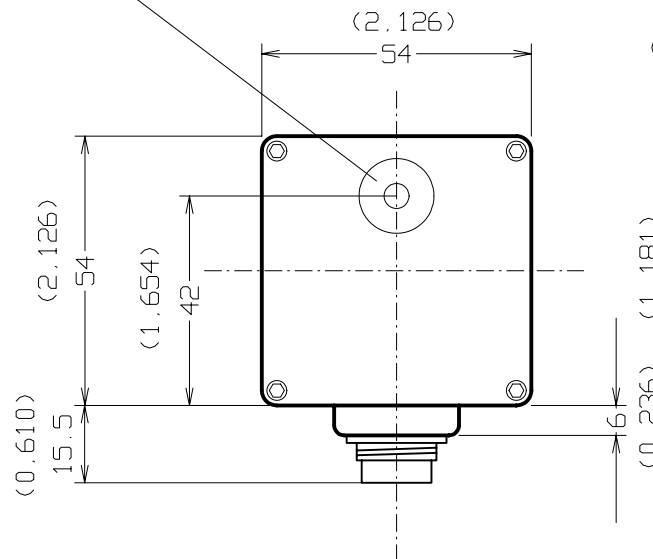

(xxx) - Maße in Zoll
(dimensions inch)

Maßstab 1:1			
Fa.Dr. Maurer GmbH			
STANDARDGEHÄUSE (standard case)			
KTRD 1000-2 Stecker 90° (connector 90°)			
Visiereinrichtung (viewfinder)			
100207			Blatt
			Bl.
Zust	Änderung	Datum	Name